

总氮(TN) 预制试剂使用方法

1. 方法适用试剂

名称	量程范围	试剂型号	数量
总氮检测预装试剂(低量程)	0.2-25mg/L	TE-TN-D-05	1 盒

2. 应用范围

适用地表水、地下水、市政污水和工业废水等各类水质中总氮(TN)的测定。试剂中的酸性物质可能会使样品中的悬浮颗粒物溶解，使溶液有浊度而造成读数不稳定，因此样品应先进行预处理，将 pH 值调至 7 左右。

3. 方法说明

- 在碱性条件下，试样和过硫酸钾在 125℃下消解 30min，将含氮化合物的氮转化为硝酸盐。消解结束后，加入偏重亚硫酸钠消除卤素类氧化物的影响。在强酸性介质中，硝酸盐和变色酸形成一种黄色配合物。
- 在酸性条件下，溴化物、氯化物等会对测定产生干扰，影响数据结果。


4. 注意事项

- 试剂中含有毒、腐蚀性物质，注意试验安全，不可直接接触试剂。
- 消解过程中样品管压力增加迅速，请穿防护服、戴防护眼镜、防护手套等做好防护措施。
- 保存时请密闭包装盒，以避免样品管受光，在阴凉暗处储存。
- 妥善放置或处理废弃试管（试管中含有毒、有害废液。可将废液倒入废液桶中集中处理，试管交由危废公司处理）。

5. 物品准备

名称	数量
总氮检测预制试剂	若干(视待测水样个数决定)
移液枪或移液管(5mL和1mL)、配套洗耳球	2只
待测水样、纯净水	保证可取样体积不少于5mL
试管架	1个

6. 操作步骤

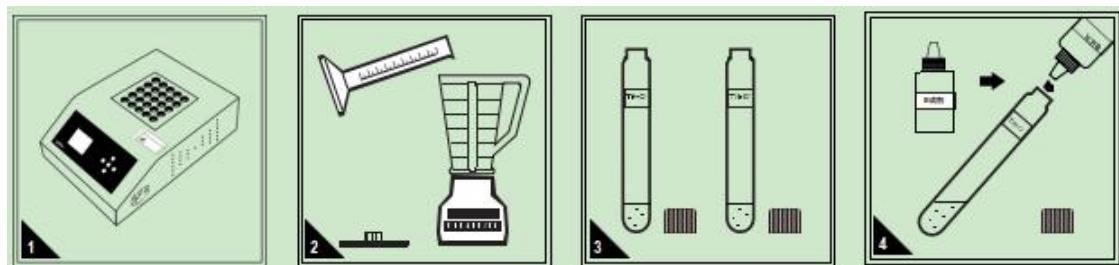


打开多功消解仪进行预热,设定程序加热温度 125 °C 加热时间 30 分钟。

将待测水样按前处理要求进行混匀或过滤等操作。对于悬浮物较多的水样,应进行搅拌等匀质化处理,以减小取样误差。

取若干比色消解管 A(白盖试管),一支作为空白样,再根据待测水样的数量选择相同数量的比色消解管作为待测样,置于试管架上。

在每支比色消解管 A 中,分别加入 4 滴 B 试剂。

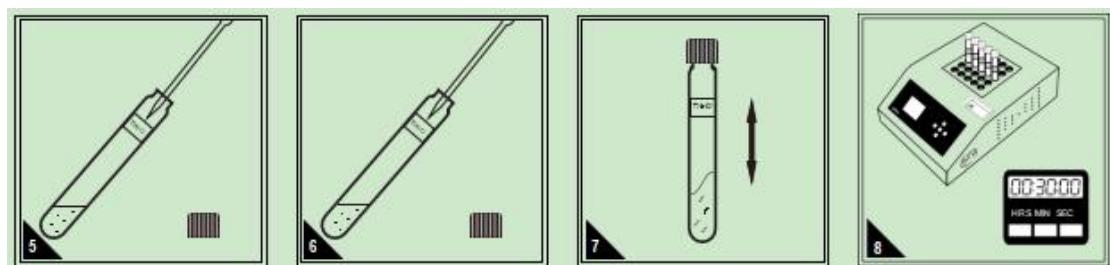


使用移液管或移液枪准确移取一定体积的蒸馏水加入到比色消解管 A 的试管内, 制成空白样。
低量程加 4.0mL。


按步骤 5 的方法移取同体积的待测水样加入到其他比色消解管 A 的试管内, 每只消解管 A 对应一个待测水样, 制成待测样, 记录试管上的编码。

拧紧管盖, 上下摇晃试管, 使试管内的试剂与水样充分混合。


消解器温度上升至 125 °C 后, 依次放入标记好的空白样和待测样, 加热消解 30 分钟。




消解时间结束，消解器进行降温，手拿管盖取出试管，放入试管架中置于通风处进行冷却，待试管降至室温左右方可进行下一步。




在冷却好的消解管 A 中，分别加入 2 滴 C 试剂，摇匀。




将摇匀后的试剂放在试管架上，静置使其反应并准确计时 2 分钟。




反应结束后取出对应数量的比色消解管 D（蓝盖试管），打开盖子，从管 A 中准确移取 1.0ml 试剂至管 D 中，拧紧管盖上下摇匀，记录试管上的编码。



将摇匀后的试剂放在试管架中，静置使其反应并准确计时 15 分钟。（反应中试管会发热，可在最后 5 分钟时间至于水浴中冷却至室温）



打开专用水质测定仪并按要求进行预热，选择相应的方法或波长进行测量。



取出反应好的试管样，用擦镜布或无毛屑的软纸擦干净试管外壁，放入水质检测仪内进行比色操作。



先放入空白样，按“空白”进行调零操作。



再放入待测样，按“检测”直接读取总氮浓度 (mg/L)。